検査内容変更のお知らせ

ISO15189:2012
認定取得

２０２４年２月

謹啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。
この度、下記の項目につきまして、**検査精度向上のため、検査内容の変更**をさせていただきたくご案内申し上げます。
先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬白

記

● **変更期日**：2024年4月1日（月）受付分より、下記のとおり変更させていただきます。
● **変更項目**および**変更内容（新試薬変更に伴う検査内容の変更）**

ｺｰﾄﾞ	検査項目名	変更箇所	変 更 後	現　行	検査案内書掲載ページ
3502	RPR（定性）	検 体 量 検査方法 基 準 値	**血清 0.5mL** **LA** **（－）**	血清 0.2mL 同左 同左	77
3507	RPR（定量）	検 体 量 基 準 値 下限報告値	**血清 0.5mL** **1.0 未満** **0.5 未満**	血清 0.2mL 同左 0.2 未満	
3504	TP 抗体（定性）	検 体 量 検査方法 基 準 値 報告形式	**血清 0.5mL** **LA** **（－）** **陰性(－)判定保留(±)陽性(＋)**	血清 0.2mL 同左 同左 陰性(－) 陽性(＋)	
3509	TP 抗体（定量）	検 体 量 基 準 値 下限報告値 単　位	**血清 0.5mL** **5 未満** **5 未満** **U/mL**	血清 0.2mL 10 未満 同左 T.U.	

※基準値は試薬添付文書から引用しました。

※梅毒 TP 抗体(定量) 判定基準

判定基準（U/mL）	判定
5 未満	陰性
5 ～9	判定保留
10 以上	陽性

■ お問い合わせ、ご意見、ご指摘、ご要望先　**カスタマーセンター**

□ 株式会社 大阪血清微生物研究所　本　　社　(06)6322-4531
奈良支社　(0744)24-0530
□ 株式会社 大阪血清田辺臨床検査センター　(0739)22-8740
□ 株式会社 大阪細胞病理研究所　(06)7634-0360

http://www.osaka-kessei.jp

●相関図

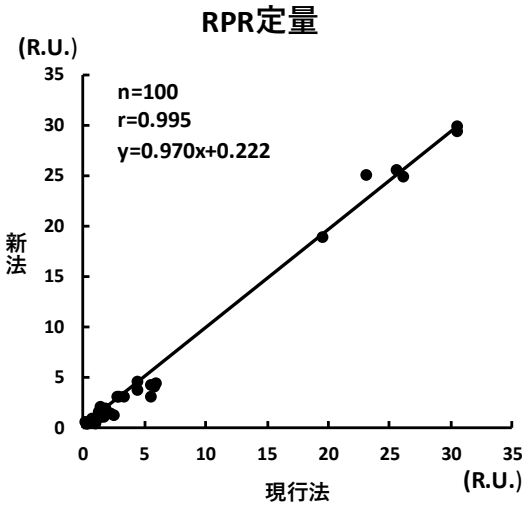

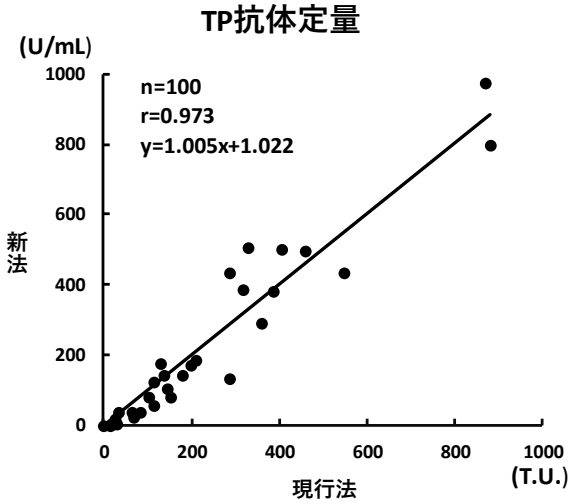

●一致率

〈RPR〉

		新法		
		(−)	(+)	計
現行法	(−)	76	0	76
	(+)	0	25	25
	計	76	25	101

全体一致率：100.0%
陽性一致率：100.0%
陰性一致率：100.0%

〈TP抗体〉

		新法		
		(−)	(+)	計
現行法	(−)	70	0	70
	(+)	3	28	31
	計	73	28	101

全体一致率：97.0%
陽性一致率：90.3%
陰性一致率：100.0%