

# 検査内容変更および 検査受託中止のお知らせ

ISO15189:2012  
認定取得

2025年3月

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記の項目につきまして、検査内容変更および試薬販売中止等のため検査受託中止させていただきたく、ご案内申し上げます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承賜りますようよろしくお願い申し上げます。

敬白  
記

- 変更期日：2025年4月1日（火）受付分より、下記のとおり変更させていただきます。
- 変更項目：


コード	検査項目名	変更箇所	変更後	現行	検査案内書 掲載ページ
3575	レチノール結合蛋白	所要日数 検査方法 基準値  下限報告値 JLAC10コード	3~4 ラテックス凝集比濁法 男 2.7~6.0 女 1.9~4.6 0.1未満 5C030-0000-023-062	3~5 ネフェロメトリー 2.5~7.1  0.2未満 5C030-0000-023-063	44
9224	ビタミンB12	検体量 保存 検査方法 基準値 下限報告値 上限報告値 JLAC10コード	血清 0.6 冷蔵 CLEIA 180~914 50未満 — 3G040-0000-023-052	血清 0.5 凍結 CLIA 233~914 25未満 1500以上 3G040-0000-023-051	44
9264	葉酸	検体量 保存 検査方法 基準値 下限報告値 上限報告値 JLAC10コード	血清 0.6 冷蔵 CLEIA 4.0以上 1.0未満 22.3以上 3G105-0000-023-052	血清 0.5 凍結 CLIA 3.6~12.9 0.4未満 20.0以上 3G105-0000-023-051	44

裏面をご覧ください

- お問い合わせ、ご意見、ご指摘、ご要望先  
 株式会社 大阪血清微生物研究所  
 株式会社 大阪細胞病理研究所

カスタマーセンター  
 本 社 (06) 6322-4531  
 奈良支社 (0744) 24-0530  
 田辺支社 (0739) 22-8740  
 (06) 7634-0360

## (相関図)

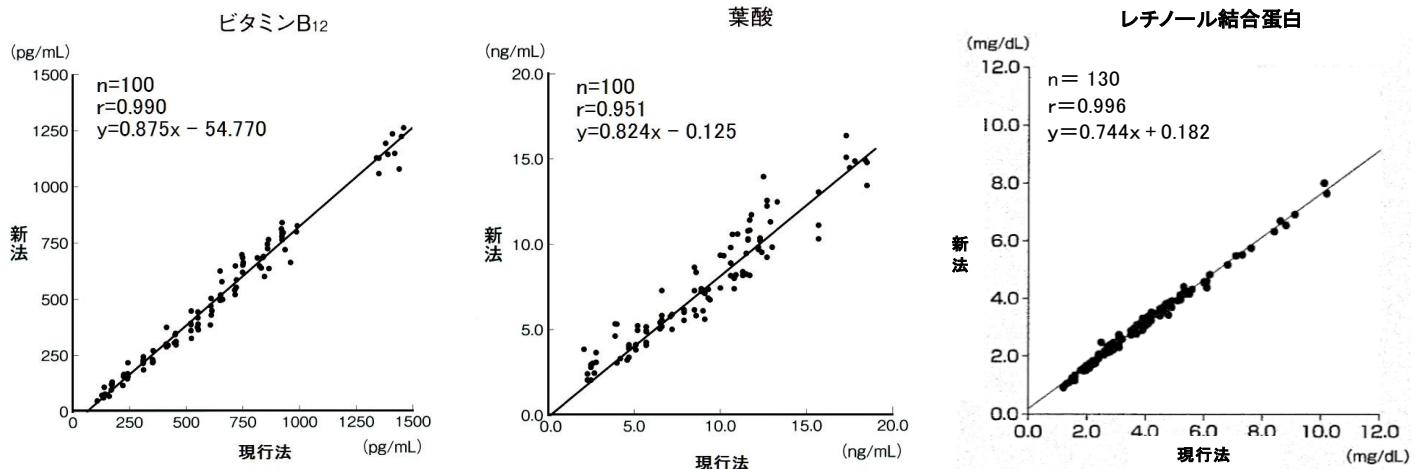

## 検査受託中止項目

- 受託中止期日：2025年3月29日（土）受付分をもって受託中止させていただきます。
- 受託中止項目

コード	検査項目名	理由	代替項目	検査案内書 掲載ページ
9106	TSHレセプター抗体定量	試薬販売中止のため	2822 TSHレセプター抗体定量 (3世代)	47 97
9335	Nアセチルプロカインアミド		なし	63
3531	免疫電気泳動(抗ヒト全血清)	測定機器老朽化のため	4241 免疫電気泳動 (特異抗血清)	68
3505	FTA-ABS(定性)	関連学会ガイドラインに 沿った検査項目に統合の ため	関連項目 3507 RPR(定量) 3509 TP抗体(定量)	77
3510	FTA-ABS(半定量)			
3796	FTA-ABS IgM(定性)			
3885	FTA-ABS IgM(半定量)			
7255	FTA-ABS(半定量)髄液			